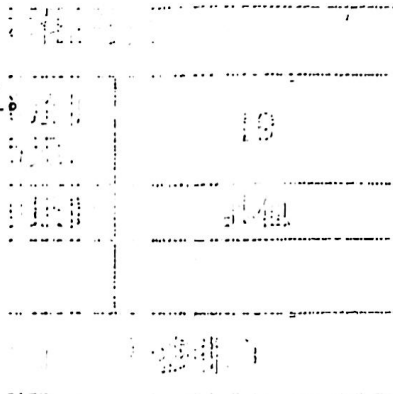


一、项目简介

项目名称	多功能全身一体化托板				
预算单价 (万元)	19	数量	1 台	预算总价 (万元)	19
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、功能要求 ▲1、底板主体材料为碳纤维材质，射线透过率$\geq 98\%$ (6MV)。 2、底板外形尺寸$\geq 2000\text{mm} \times 610\text{mm}$。 3、承重$\geq 150\text{kg}$。 ▲4、可用于 SRS 和 SBRT 患者治疗。 5、具备头枕，可调节适应不同身高的患者。 6、具备握杆，防滑质地，有刻度指示。 7、具备分腿装置，可分档调节。 8、底板底部具备固定条卡槽，安装完成可稳固固定。 ▲9、底板的两侧具备刻度尺，头部两侧具备中分刻度尺。 10、具备碳纤维材质举臂支架。 11、支撑臂托可调节高度、角度。 ▲12、具备碳纤维材质呼吸控制弓形尺。 13、弓形尺具备滑轨式移动和固定方式。 14、具备呼吸限制装置，高度可调，有刻度指示。 15、具备腿部固定装置，高度可调。 16、具备膝垫、脚垫，高度可调。 ▲17、具备俯卧盆腔定位装置。 18、可对俯卧盆腔定位装置表面进行酒精消毒。 19、俯卧盆腔定位装置具备至少两个规格的适配器，供不同体型患者使用。 二、配置要求 1、碳纤维底板 1 块 2、头枕 1 套 3、举臂支架 1 套 4、呼吸控制弓形尺 1 套 5、膝垫 1 套 6、脚垫 1 套 7、俯卧盆腔定位装置 1 套 8、体膜 1 套 9、设备资料 1 套 10、快捷操作卡 1 张			
--	--	--	--